

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

ZADAVATEL

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Radiová 1285/7, 102 31 Praha 10
IČ: 00027022, DIČ: CZ00027022
zapsaná v rejstříku v.v.i., vedeném u MŠMT, spis.zn. 22971/2006-11000

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Dodávka pilotního (laboratorního) fermentoru“

EVIDENČNÍ ČÍSLO: Z2017-023896
SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: P17V00001567

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku rozhodl o vyloučení nabídky BioTech a.s.

Odůvodnění

Zadavatel rozhodl o vyloučení nabídky v souladu se závěry hodnotící komise. Nabídka společnosti BioTech a.s., IČ: 25664018 byla hodnotící komisí vyloučena z důvodu, že nebyly splněny požadavky zadávací dokumentace, a to v následujících bodech:


1. Zadavatel požaduje splnění normy ISO 14001:2004 výrobcem. (není doloženo) Výrobce Bertinox; Via D.Chiesa 24 – Leffe dle stránek <http://www.bertinox.com/certificazioni/> tímto certifikátem nedisponuje.
2. Zadavatel požaduje katalog výrobce (možné i odkazem na webovou stránku), kde je uvedeno prezentující dané konkrétní zařízení s jeho specifikacemi. Výrobce neprezentuje dané konkrétní zařízení. Výrobce uváděné specifikace v katalogu nesouhlasí s požadavky uvedenými ve VŘ (min. pracovní objem pro 150 l fermentor 37,5 l - požadavek 20 l; geometrie nádoby 2.7/3.1 – požadavek 1:3)
3. Výrobce nedoložil požadované maximální rozměry zařízení (Š x H x V) 150 x 150 x 300 cm celkovým (obecným) výkresem bioreaktoru.
4. Výrobce nedoložil, že výpust fermentoru se nachází v min. výšce 40 cm nad podlahou celkovým (obecným) výkresem bioreaktoru.
5. Výrobce nesplnil požadavek na otáčky motoru v rozmezí 0 – 900 RPM. V dokumentu od výrobce str. 36 je uvedeno 0 – 450 RPM.
6. Výrobce nedoložil celkovým (obecným) výkresem, či fotografií bioreaktoru signalizační systém upozorňující na poruchu, jasně viditelný ze vzdálenosti.
7. Není doložena přesnost vážení kultivační nádoby s přesností +/- 0,005% a to dokumentem vydaným výrobcem zařízení.
8. Výrobce nesplňuje požadavek na motor míchadla chlazený vodou – z příložené dokumentace str. 35, 36 a 38 je zřejmé, že motor míchadla nabízeného zařízení je chlazený vzduchem.
9. Výrobce fotografií na str. 38 dokládá nesplnění požadavku mobilního provedení na kolečkách.

10. Výrobce dostatečně nedoložil plně automatickou SIP sterilizaci parou IN-SITU, popis dostatečně nevystihuje proceduru spuštění a průběhu sterilizace bioreaktoru s ohledem na manuální zásahy ze strany uživatele.
11. Výrobce nedoložil splnění požadavku chladiče odchozích plynů s ohřevem, z dokumentace str. 35, 36, 37, nelze potvrdit splnění požadavku.
12. Z přiložené dokumentace nevyplývá možnost propařování výstupního potrubí přes vzdušnici věnec.
13. Výrobce nedoložil dokumentací dostatečně splnění požadavku: vzorkovací ventil s možností kontinuálního odběru a vypouštěcí ventil, oba v aseptickém provedení s možností propaření, vnitřní průměr vzorkovacího potrubí min. 4 mm, vnitřní průměr vypouštěcího potrubí min. 25 mm
14. Dle přiložené dokumentace od výrobce (User manual – SCADA) nebylo prokázáno splnění požadavku možnosti tvorby kaskády řízení parametrů
15. Dle přiložené dokumentace od výrobce (User manual – SCADA) nebylo prokázáno splnění požadavku provedení aplikace v režimu web-based bez nutnosti instalace na všechny uživatelské stanice v rámci sítě. Naopak z přiložených snímků obrazovky je patrné, že se jedná o aplikaci běžící pod operačním systémem MS Windows (WinCC).
16. Dle přiložené dokumentace od výrobce (User manual – SCADA) nebylo prokázáno splnění požadavku zobrazení dynamických i fixních alarmů – nebylo prokázáno, že systém umožňuje nastavení dynamických alarmů pro jednotlivé parametry kultivace.
17. Není doložena výrobce kompatibilita s mobilními systémy (tablet / telefon).
18. Není doložena výrobce možnost archivace kultivací, evidence vlastních mikroorganismů a živných médií.
19. Žádný z přiložených dokumentů neprokazuje, že uživatel má nárok na bezplatné on-line školení přímo výrobcem SCADA programu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení v souladu s ustanovením § 242 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V Praze, dne 20.10.2017

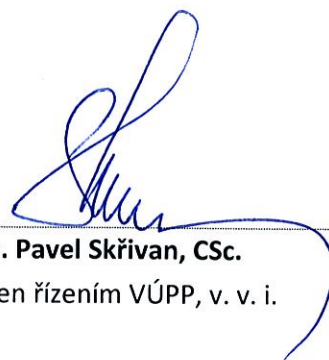

Ing. Pavel Skřivan, CSc.
pověřen řízením VÚPP, v. v. i.